

2020年2月吉日

お客様各位

販売元：株式会社カネカメディックス

シラスコン製品 滅菌バッグの紙材変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、シラスコン製品（排液バッグ、閉鎖式排液バッグ、脳室ドレナージ回路）の滅菌バッグの紙材を、製造上の事情により下記のとおり変更致します。

何卒、ご了承賜り、引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

カタログ番号	名称
770N	シラスコン® 排液バッグ

カタログ番号	名称
781-1N	シラスコン® 閉鎖式排液バッグ
781-2N	シラスコン® 閉鎖式排液バッグ（クランプ付）


カタログ番号	名称
775N	シラスコン® 脳室ドレナージ回路
775-120N	シラスコン® 脳室ドレナージ回路（120cm）
776N	シラスコン® 脳室ドレナージ回路 （ワンタッチ式クランプなし）
776-120N	シラスコン® 脳室ドレナージ回路 （ワンタッチ式クランプなし 120cm）
779N	シラスコン® 脳室ドレナージ回路（定量計付）

【変更内容】

変更前	変更後
イージーピールシーラント 50	タイベック 1059B

※製品本体の変更はなく、又、滅菌への影響もございません。

滅菌バッグ 紙材)

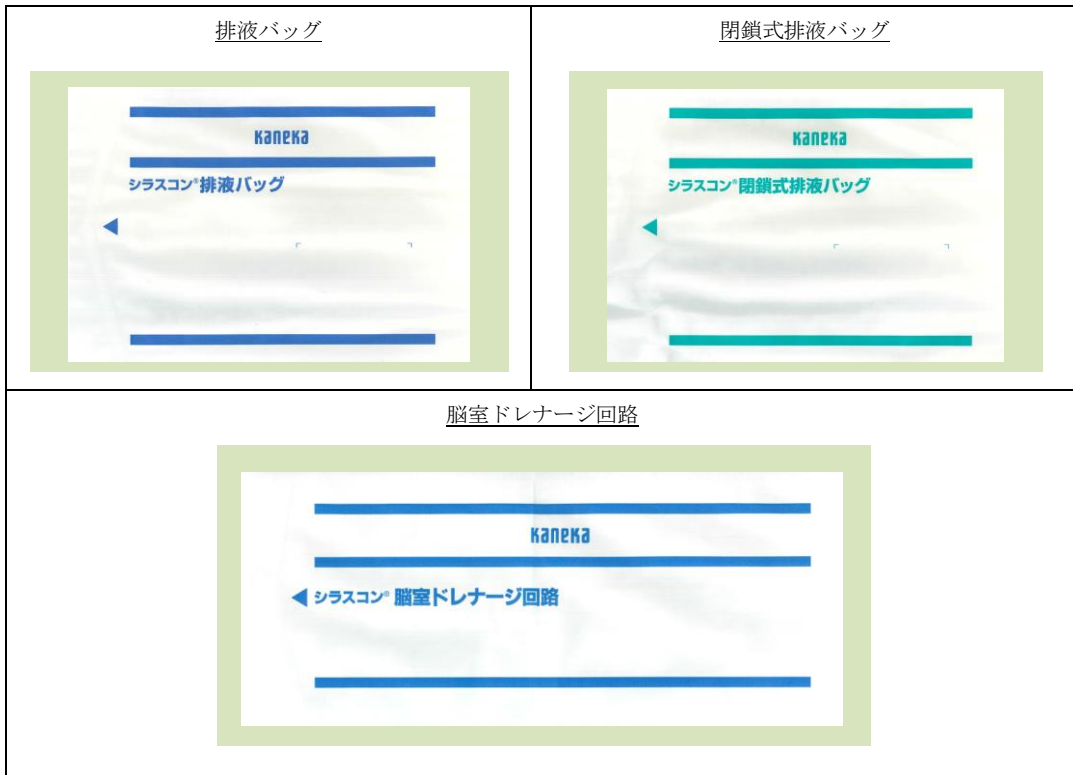

【変更時期】

製品	変更時期
排液バッグ	2020年2月頃の出荷分から順次
閉鎖式排液バッグ	
脳室ドレナージ回路	2020年5月頃の出荷分から順次

以上