

取引先各位

製造販売元：株式会社カネカ
販売元：株式会社カネカメディックス

**中心循環系血管内塞栓促進用補綴材『i-ED COIL』
のラベル表示変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、i-ED COIL「14∞」のラベル表示を、製品取り扱い上の理由により、下記のとおり変更する事となりましたのでご案内申し上げます。(国内薬機法に準拠したラベル表示に関して変更はございません。)
なお、当該製品の本体、カタログ番号、JANコード、添付文書、使用方法等に変更はございません。
今後とも、より一層のご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具


記

対象製品： i-ED COIL「14∞」 (カタログ番号：373-040815・373-040830・373-051250)

変更時期： 2020年9月以降順次 (ロット番号：KR080269 より) 出荷状況により多少時期が変動します。
注) 変更後暫くは、変更前品と変更後品が混在いたします。

主な変更内容： 下記表に赤枠で示しております。

- ① 二次径表記を変更 (コイル径表記から参考使用径 (参考使用範囲) 表記に)
- ② コイル展開図を変更

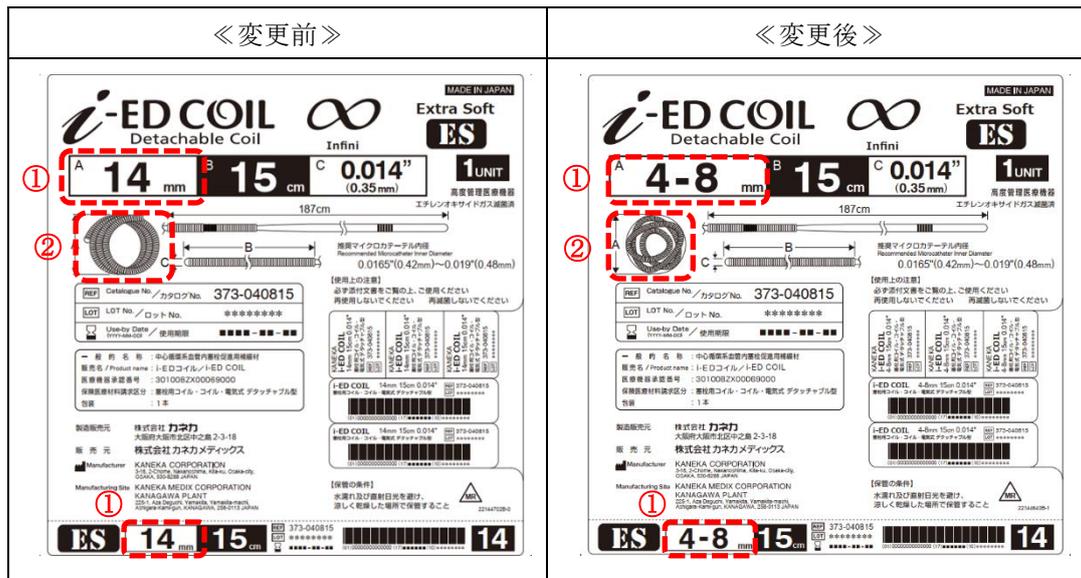

以上