

2024年3月吉日

お客様各位

販売元：株式会社カネカメディックス

## シラスコン®閉鎖式排液バッグ クランプの仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、シラスコン®閉鎖式排液バッグのクランプの仕様を下記の通り変更いたします。

シラスコン®閉鎖式排液バッグを付属しております、シラスコン®硬膜外ドレナージセット、シラスコン®硬膜下ドレナージにも該当する製品がございますので、下記の対象製品をご確認頂けますと幸甚に存じます。

何卒、ご理解を賜り、引き続きシラスコン®製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具


記

### 【変更内容】

クランプの形状を変更

### 【変更理由】

クランプの操作性（閉塞性、開閉のしやすさ）を向上するため

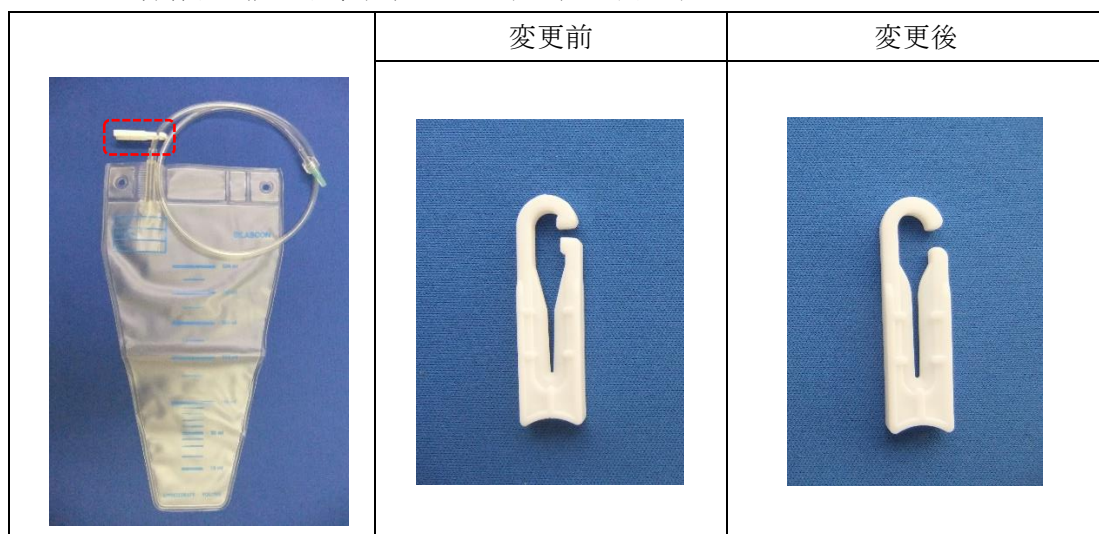

**【対象製品と変更時期】**

2024年5月頃の出荷分から順次

カタログ番号	販売名	製造販売元
781-2N	シラスコン®閉鎖式排液バッグ 届出番号：09B1X00004000111	フォルテグロウメディカル株式会社
780-4A	シラスコン®硬膜外ドレナージセット 医療機器承認番号：15400BZZ00710000	株式会社カネカ
785-5A	シラスコン®硬膜下ドレナージ 医療機器承認番号：20200BZZ01174000	株式会社カネカ

- ※ 変更時期は前後することがあります。
- ※ JANコードの変更はございません。

以上